



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“SANTOBONO PAUSILIPON”  
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 NAPOLI

Verbale n.5 del 05 febbraio 2021

**Oggetto: R.D.O. n. 2576965 - Procedura di gara sotto soglia comunitaria per la fornitura e posa in opera, suddivisa in due lotti, di n. 1 colonna per videolaparoscopia - urologica (Lotto 1 – base di gara Euro 160.000,00 + Iva ) e vari set di cistoscopi, ureteroscopi e rettoscopi ( Lotto 2 – prezzo a base di gara euro 50.000,00 + Iva) per le esigenze della Camera operatoria di Urologia pediatrica - Importo a base di gara complessivo € 210.000,00 + Iva**

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di febbraio 2021 alle ore 9:20, sono presenti, in seduta riservata, presso il P.O. Santobono, i componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nominato con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 20.07.2020 successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n.776 del 01.10.2020 ed ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 29.12.2020 che risulta così costituita:

PRESIDENTE : Dott. Fonzone Caccese Antonio - Dirigente medico in servizio c/o U Urologia Pediatrica;  
COMPONENTE: Dott. Francesco Turrà - Dirigente medico in servizio c/o U Urologia Pediatrica;  
COMPONENTE: Dott. Giovanni Torino – Dirigente medico in servizio c/o il Dipartimento di Scienze chirurgiche;

SEGRETARIO: Dr.ssa Erica Ferri – Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

A causa delle misure restrittive adottate dal Governo per l'attuale emergenza epidemiologica da Covid -19 ed in conformità a quanto disposto dal la Delibera n. 312 del 09.04.2020 adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha stabilito, al punto 2.9, “la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni”, la riunione avviene da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma aziendale CISCO Webex Meetings (in particolare, i membri tecnici della Commissione si riuniscono presso il P.O. Santobono, mentre il Direttore dell'UOC Acquisizione beni e servizi è in collegamento con gli stessi tramite la piattaforma informatica indicata dalla sede di via della Croce Rossa) .

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale n.329 del 26.05.2020 è stata indetta una procedura sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera, suddivisa in due lotti, di n. 1 colonna per videolaparoscopia - urologica ( Lotto 1 – base di gara Euro 160.000,00 + Iva ) e vari set di cistoscopi, ureteroscopi e rettoscopi ( Lotto 2 – prezzo a base di gara euro 50.000,00 + iva) per le esigenze della Camera operatoria di Urologia pediatrica - Importo a base di gara complessivo € 210.000,00 + Iva;
- che in data 29.05.2020, con R.D.O. n. 2576965 sono stati invitati tutti gli Operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 23.06.2020;
- che, entro il citato termine, sono pervenute offerte unicamente per il lotto 1 “ Fornitura e posa in opera di una colonna per videolaparoscopia urologica” degli Operatori economici di seguito indicati unitamente ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma MEPA:

Operatore economico	Estremi di ricezione	Lotto di partecipazione
1. M.END.EL. S.R.L.	19/06/2020 12:50:55	1
2. OLYMPUS ITALIA S.R.L.	23/06/2020 10:35:00	1

*ferri* *A. C.* *Francesco Turrà* *Giovanni Torino* *Erica Ferri* 1



Visto il verbale n. 1 del 04.08.2020 del Seggio di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta l'ammissione con riserva di entrambi gli Operatori economici partecipanti, per le motivazioni tutte riportate nel citato verbale, ed è stato contestualmente dichiarato deserto il lotto 2 : "Fornitura di set di vari cistoscopi ureteroscopi e rettoscopi".

Visto il verbale n. 2 del 24.09.2020 del Seggio di gara, agli atti, dal quale risulta che gli Operatori economici Olympus Italia S.r.l. e M.end.el S.r.l., hanno regolarizzato, nei termini previsti, la documentazione amministrativa richiesta e pertanto si conferma la loro ammissione alle successive fasi di gara

Visto il verbale n. 3 del 13.10.2020 della Commissione di gara, dal quale risulta l'apertura sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche digitali, la cui documentazione è stata acquisita dalla Commissione su supporto informatico ed assunta in custodia dal Presidente, per l'esame in seduta riservata della conformità capitolare dei prodotti offerti e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Visto il verbale n. 4 del 14/01/2021, dal quale risulta la sostituzione di un membro della Commissione e l'inasediamento della stessa nella nuova composizione;

Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche – compiuto nella seduta riservata del 18/01/2021 - la relazione tecnica e le schede giudizi allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale - nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara per il lotto 1 rubricato "Fornitura con posa in opera di n. 1 colonna per videolaparoscopia urologica".

Si precisa che l'Operatore economico Olympus Italia S.r.l. è stato escluso dalla procedura di gara in quanto l'offerta tecnica presentata è stata giudicata non conforme alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato tecnico per le motivazioni tutte riportate nella relazione della Commissione di gara.

Fornitura con posa in opera di n. 1 colonna per videolaparoscopia urologica	Punteggio di qualità
1. Mendel S.r.l.	70

In prosieguo, in seduta pubblica sul MEPA alle ore 9:40, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 2040 del 29.01.2021 la Commissione procede all'inserimento dei giudizi di qualità sulla piattaforma del MEPA ed all'apertura dell' offerta economica e del relativo dettaglio economico della ditta ammessa al prosieguo della procedura di gara.

La Commissione ne dà lettura e redige le seguenti graduatorie:


Fornitura con posa in opera di n. 1 colonna per videolaparoscopia urologica	Punteggio di qualità	Punteggio economico	Prezzo offerto	Punteggio totale
1. Mendel S.r.l.	70	30	150.676,96	100

La Commissione, riscontrata la conformità dell' offerta economica dell'unica ditta ammessa, propone quale aggiudicatario della presente procedura per il lotto 1 l'Operatore economico Mendel S.r.l. per la fornitura e posa in opera di n. 1 colonna per videolaparoscopia urologica per le esigenze dell' U.O.C. Urologia Pediatrica dell'AORN Santobono Pausilipon, che ha formulata l'unica offerta valida per un prezzo inferiore alla base di gara. La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza.


La Commissione medesima, infine, termina i lavori e chiude la seduta, mediante interruzione della riunione da remoto attraverso la piattaforma CISCO Webex Teams alle ore 9:50.

Del che è verbale che letto e confermato, non viene sottoscritto contestualmente dai presenti, ma l'acquisizione delle sottoscrizioni avverrà con modalità tradizionale presso la sede del P.O. Santobono.


IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO

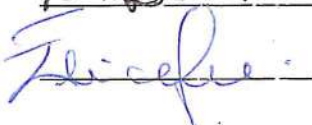


**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

RELAZIONE

R.D.O. n. 2576965 - Procedura di gara sotto soglia comunitaria per la fornitura e posa in opera, suddivisa in due lotti, di n. 1 colonna per videolaparoscopia – urologica (Lotto 1 – base di gara Euro 160.000,00 + Iva ) e vari set di cistoscopi, ureteroscopi e rettoscopi ( Lotto 2 – prezzo a base di gara euro 50.000,00 + Iva) per le esigenze della Camera operatoria di Urologia pediatrica - Importo a base di gara complessivo € 210.000,00 + Iva

In data 18.01.2021 presso il P.O. Santobono sono presenti il Dott. Antonio Fonzone Caccese in qualità di Presidente della Commissione di gara per la fornitura di n. 1 colonna di videolaparoscopia urologica, unitamente ai componenti Dott. Giovanni Torino e Francesco Turrà. Di seguito a conclusione dei lavori della Commissione di gara si trasmette la seguente relazione unitamente alla griglia di attribuzione punteggi di qualità con relative motivazioni.

GIUDIZIO DI CONFORMITA'


In riferimento alle "CARATTERISTICHE GENERALI APPARECCHIATURA" veniva espressamente richiesto: "Sistema carrellato con doppio monitor LED medicale (uno di almeno 55 pollici, l'altro di almeno 32 pollici) ad elevatissima risoluzione (i.e. UHD, 4k) e 3D, ingressi: HDMI, DVI, SDI, HD-SDI, 3G". Il prodotto offerto dalla ditta Olympus Italia S.r.l. è costituito da un monitor 31" 3D 4K SONY "LMDX310ST"/Classe I e monitor 55" 3D 4K SONY "LMDX550ST"/Classe I che non raggiunge, quindi, il requisito minimo richiesto.

Veniva poi richiesto: "Fonte luce led ad alta intensità luminosa regolabile con potenza non inferiore a 300W". La ditta Olympus Italia S.r.l. dichiarava nell'offerta "DOTAZIONE PRESENTE", invece, si evince dalla scheda tecnica che il prodotto ha luce allo XENON, che quindi non risponde alle caratteristiche minime richieste.

Riguardo il "video laparoscopio 3D" si richiedeva l'acquisizione di un'immagine con risoluzione 4K. Tale caratteristica dalla scheda tecnica del prodotto si evince non essere presente nell'apparecchio proposto dalla ditta Olympus s.r.l. che mostra la caratteristica di essere FULL HD visione ad alta definizione FULL HDTV 1080 linee (1920x1080p) per strumenti con risoluzione nativa HDTV, pertanto non raggiunge il requisito minimo richiesto.

In conclusione, in ragione delle osservazioni fatte, si procede ad esclusione dell'offerta della ditta Olympus Italia S.r.l. dalle griglie di valutazione.

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI



Handwritten signatures of Francesco Turrà and Giovanni Torino.



**CRITERIO 1: VIDEOPROCESSORE (es tipo scansione utilizzata per l'acquisizione e la riproduzione delle immagini, sistema di enfattizzazione del pattern vascolare, modalità di gestione del processore da parte dell'utilizzatore, 3D,4K, indocianina)**

Da quanto si evince dalla documentazione prodotta per ciò che concerne le caratteristiche del VIDEOPROCESSORE della ditta M.END.EL. S.r.l. vengono espone chiaramente e in modo esaustivo le caratteristiche richieste il tipo di scansione dell'immagine, la qualità, la presenza di un'unica unità per processare immagini in UHD, 4K e 3D (inclusa la definizione in 4K dell'immagine 3D) che appaiono rispondere pienamente alla richiesta fatta. In considerazione di quanto esposto si reputa l'offerta valida e si assegna un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 2: TESTINE TELECAMERE**

Dalla presa in esame della documentazione fornita dalle ditte si evince che "TESTA TELECAMERA PER LAPAROSCOPIA" della ditta M.END.EL. S.r.l mostra completa aderenza alle caratteristiche formulate; che il "VIDEOLAPAROSCOPIO 3D" mostra le caratteristiche richieste garantendo una definizione in 4K e in 3D; che la "TESTA TELECAMERA ENDOSCOPIA UROLOGICA" mostra completa aderenza alle caratteristiche formulate. In considerazione di quanto esposto si giudica l'offerta valida e si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 3: Caratteristiche ottiche**

Dalla documentazione tecnica presentata nell'offerta della ditta M.END.EL. S.r.l. si può evincere rispondenza al requisito.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 4: FONTE LUCE (caratteristiche delle lampade e livello di efficienza e sicurezza delle stesse)**

Dalla documentazione fornita, l'offerta della ditta M.END.EL. S.r.l. si può evincere rispondenza al requisito.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 5: Insufflatore (sistemi di regolazione e controllo, flusso, sistemi sicurezza) e pompa di lavaggio**


Dalle schede tecniche presentate nell'offerta della ditta M.END.EL. S.r.l. si può evincere rispondenza al requisito.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 6: Monitor (dimensioni, risoluzione, gestione etc..)**

La ditta M.END.EL. S.r.l. propone "MONITOR MEDICALE 55", 4K, 3D e 2D e Monitor 32" 4K/3D", che, dalle caratteristiche delle schede tecniche, rispondono alle caratteristiche richieste: "Sistema carrellato con doppio monitor LED medicale (uno di almeno 55 pollici, l'altro di almeno 32 pollici) ad elevatissima risoluzione (i.e. UHD, 4k) e 3D", ingressi: HDMI, DVI, SDI, HD-SDI, 3G.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

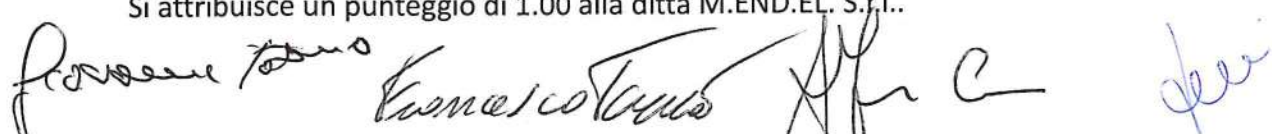

**CRITERIO 7: Carrello (ergonomia, sicurezza, flussi garantiti, funzionalità..)**

La ditta M.END.EL. S.r.l. propone "CARRELLO CON 4 PIANI PROFESSIONAL POWER (AREA UTILE 620X500 MM) REGOLABILE IN ALTEZZA E N.1 PIANO BASE (AREA UTILE 620X420 MM), che, dalle caratteristiche delle schede tecniche, risponde alle necessità lavorative.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 8: Modulo archiviazione e gestione anagrafica**

Il sistema AIDA della ditta M.END.EL. S.r.l. permette di acquisire foto e video in qualità elevate (4K), garantisce di azzerare i tempi di finalizzazione impedendo così erronee disconnessione e perdita di dati con una capacità di 2TB che risulta ampiamente soddisfare i requisiti minimi richiesti.

Si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l..

**CRITERIO 9: Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi).**


Per l'estensione della garanzia, la ditta M.END.EL. S.r.l. offre per le attrezzature offerte una garanzia full risk di 48 mesi dalla data di collaudo effettivo. In considerazione di ciò si attribuisce un punteggio di 1.00 alla ditta M.END.EL. S.r.l.

In Fede

Dott. Antonio Fonzone Caccese

Dott. Giovanni Torino

Dott. Francesco Turrà

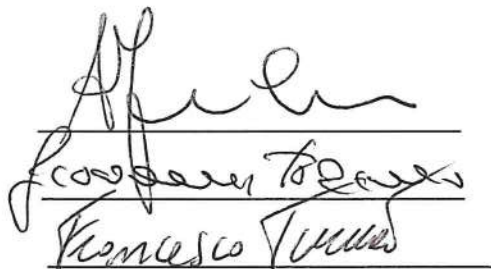

Napoli, 18 Gennaio 2021





LOTTO 01		
		Mendel
VIDEOPROCESSORE (es tipo scansione utilizzata per l'acquisizione e la riproduzione delle immagini, sistema di enfattizzazione del pattern vascolare, modalità di gestione del processore da parte dell'utilizzatore, 3D,4K, idincianina)	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
TESTINE TELECAMERE	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
Caratteristiche ottiche	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
FONTE LUCE (caratteristiche delle lampade e al livello di efficienza e sicurezza delle stesse)	Punti massimi attribuibili	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00
	Giudizio Commissario 2	1,00

*Procedura Torneo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00
Insufflatore (sistemi di regolazione e controllo, flusso, sistemi sicurezza) e pompa di lavaggio	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
Monitor (dimensioni, risoluzione, gestione etc..)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Carrello (ergonomia, sicurezza, flussi garantiti, funzionalità..)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Modulo archiviazione e gestione anagrafica	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Francesco Tundo  
Francesco Tundo*



<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia, la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere il servizio di manutenzione full risk (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio qualità relativo:</p> <p>Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 24 mesi punti 4  Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 18 mesi punti 3  Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 12 mesi punti 2  Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 6 mesi punti 1</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>4,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	<p>4,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario2</p>	<p>4,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario3</p>	<p>4,00</p>

*Francesco Turchio*

*Francesco Turchio*

*per*

*[Signature]*



LOTTO 01

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Medel
Punti qualità attribuiti Comm.1	70,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	70,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	70,00
Media dei punti di qualità attribuiti	70,00
Punteggio massimo attribuito	70,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Medel
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Medel
Punti qualità riparametrizzati	70,00

*Francesco Tundo*  
*Francesco Tundo*  
*FFC*

*speci-*



LOTTO 01	
DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Mendel	70

per  
Francesco Tommaso  
Francesco Tommaso  
Africa