

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"  
Via della Croce Rossa,8 -80122- Napoli*

**VERBALE N° 4 del 18/03/2019**


*Procedura di gara sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A RDO N. 2049929, per il noleggio triennale di un apparecchio Laser per il trattamento delle vie urinarie per le esigenze della U.O.C. Urologia Pediatrica del P.O. Santobono – Importo a base di gara € 120.000,00 oltre IVA.*

L'anno **2019** il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore 15:15, negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via della Croce Rossa, 8 – Napoli sono presenti **in seduta riservata**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determinazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi n° **626** del **10/10/2018**, che risulta così costituita

PRESIDENTE	Dott. Antonio Fonzone Caccese	Dirigente Medico c/o UOC Urologia Pediatrica P.O. Santobono
COMPONENTE	Dott. Salvatore Angelone	Dirigente Medico c/o UOC Urologia Pediatrica P.O. Santobono
COMPONENTE	Dott.ssa Laura Sorrentino	Dirigente Medico c/o Direzione Medica P.O. Santobono
SEGRETARIO	Dott.ssa Erica Ferri	Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 433 del 05 Settembre 2018, è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento del noleggio in oggetto;
- che con RDO n. 2049929 del 07.09.2018 sono state invitate tutte le ditte presenti sul mercato elettronico;
- che entro le ore 13:00 del 26.09.2018 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
  1. CARLO BIANCHI SRL
  2. DBI
  3. FAD SRL
  4. OLYMPUS ITALIA SRL
  5. UROLOGY DIAGNOSTIC
- che entro il medesimo termine assegnato del 26/09/2018, ore 13:00, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente mediante posta - come richiesto dal punto 7.V del disciplinare di gara - i plichi contenenti le offerte tecniche delle seguenti ditte:
  1. CARLO BIANCHI SRL prot.14779 del 25.09.2018 ore 12:55
  2. DBI prot. 14754 del 25.09.2018 ore 09:37
  3. FAD prot. 14751 del 25.09.2018 ore 08:41
  4. OLYMPUS ITALIA SRL prot.14812 del 26.09.2018 ore 09:42
  5. UROLOGY DIAGNOSTIC prot.14686 del 24.09.2018 ore 12:19
  6. ROCAMED FRANCE PROT. 14915 DEL 27.09.2018 (pervenuta solo l'offerta tecnica **oltre** il termine ultimo di presentazione delle offerte - Non ha formulato l'offerta sul MEPA. Pertanto la Ditta non può essere considerata concorrente nella presente procedura di gara)

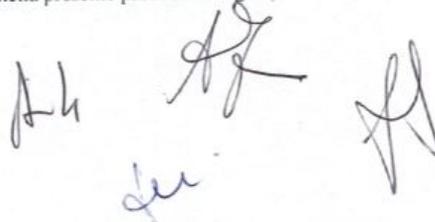

Visto il verbale n.1 del 22.10.2018, agli atti dal quale risulta l'ammissione delle Ditte CARLO BIANCHI SRL, DBI e OLYMPUS ITALIA SRL mentre l'ammissione con riserva delle Ditte FAD e UROLOGY DIAGNOSTIC;

Visto il verbale n.2 del 31.10.2018 dal quale risulta che, con nota prot. 16647 del 25.10.2018, la ditta UROLOGY DIAGNOSTIC e nota prot.16493 del 23.10.2018 la Ditta FAD hanno prodotto tramite la piattaforma del MEPA i documenti richiesti e, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, il seggio di gara ne ha confermato l'ammissione alla procedura di gara;

Visto il verbale n.3 del 15.11.2018 dal quale risulta l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, la cui documentazione è stata assunta in custodia dal Presidente della Commissione, per l'esame in seduta riservata della conformità del prodotto offerto al capitolato e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche - compiuto nelle sedute riservate riportate in allegato - la relazione tecnica e le schede allegate quale parte integrante e sostanziale del presente verbale - nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara e la relativa relazione illustrativa.

Si precisa che il Commissario 1 è il Presidente, dr. Antonio Fonzone Caccese; il Commissario 2 è il dr. Salvatore Angelone; il Commissario 3 è la dr.ssa Laura Sorrentino

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
FAD	70
CARLO BIANCHI SRL	Esclusa: per assenza di alcuni dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale a pena di esclusione (cfr. relazione allegata)
DBI	Esclusa: per assenza di alcuni dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale a pena di esclusione (cfr. relazione allegata)
OLYMPUS ITALIA SRL	Esclusa: per assenza di alcuni dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale a pena di esclusione (cfr. relazione allegata)
UROLOGY DIAGNOSTIC	Esclusa: per assenza di alcuni dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale a pena di esclusione (cfr. relazione allegata)





La Commissione dà mandato al RUP di comunicare l'esclusione alle Ditte non ammesse ed aggiorna la seduta pubblica alla data del 27/03/2019 ore 15:00.

La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza e termina i lavori alle ore 16:39. Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

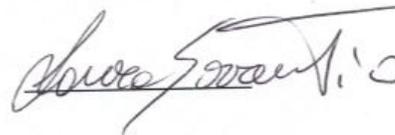

**Oggetto: Relazione valutazione laser**

**Commissione:**

Presidente Dott. Antonio Fonzone Caccese  
Componenti commissione Dott. Salvatore Angelone, Dott.ssa Laura Sorrentino

La commissione si è riunita in seduta riservata in date diverse.  
Si sono svolti due incontri per la valutazione pratica delle apparecchiature presentate.  
Si sono svolti 3 incontri per l'attribuzione del punteggio.

Si sono presentate cinque ditte:

- Carlo Bianchi
- DBI
- FAD
- Olympus
- Urology Diagnostic

Tutti gli apparecchi sono stati valutati in base alla scheda del Dettaglio Tecnico e relative Caratteristiche Tecniche di minima a pena di esclusione riportato nel capitolato di gara.

**La Ditta Carlo Bianchi – MultiPulse HO - Jena Surgical**

**viene esclusa:**

In riferimento all'erogazione di potenza regolabile richiesta da 1 a 30W, non viene specificato il minimo erogabile.

Viene dichiarata una frequenza da 1 a 30Hz, dato in contraddizione con la restante documentazione tecnica presentata, dove invece è indicata frequenza da 3 a 30 Hz. Non è possibile programmare il treno di impulsi. Non è indicata la potenza massima di picco.

Non viene specificato il funzionamento impulsato, il laser ha solo programmi preimpostati.

Non permette la regolazione della durata dell'impulso durante l'intervento.

Non ha luce guida ad intermittenza quando il sistema è in standby.

Non ha sportello di connessione automatico.

Raffreddamento autonomo senza utilizzo di impianti ausiliari, ma il laser ha un livello di rumorosità elevato.

Ha il riconoscimento automatico delle fibre inserite ma non è dotato di sistema di bloccaggio in caso di potenza superiori a quelle supportate dalla fibra stessa.

Tutti gli altri requisiti sono conformi.

**Ditta DBI – Auriga 30 Boston Scientific**

**viene esclusa:**

Al  
Al  
Al

Al

In riferimento all'erogazione di potenza regolabile richiesta da 1 a 30W, si evince che l'apparecchiatura parte da un minimo di 1,8W.

In riferimento alla frequenza richiesta da 1 a 20Hz, si evince che parte da un minimo di 6Hz. Non è indicata la potenza massima di picco.

Il funzionamento impulsato non è specificato (solo programmi preimpostati)

Non permette la regolazione della durata dell'impulso durante l'intervento

Non viene indicata luce guida intermittente quando il sistema è in standby

Sportellino connessione fibre non automatico.

Ha il riconoscimento automatico delle fibre inserite ma non è dotato di sistema di bloccaggio in caso di potenza superiori a quelle supportate dalla fibra stessa

Tutti gli altri requisiti sono conformi.

**La Ditta FAD – Sphinx Jr. – Lisa Laser**

**e' conforme ai requisiti richiesti.**

**Ditta Olympus – Empower H35R – Quanta**

**viene esclusa:**

in riferimento alla frequenza richiesta da 1 a 20Hz, viene dichiarata frequenza da 3 a 30 Hz. Non è indicata la potenza massima di picco.

il funzionamento impulsato prevede solo programmi preimpostati

Non permette la regolazione della durata dell'impulso durante l'intervento

non è presente la luce guida ad intermittenza quando il sistema è in standby

Non viene specificata la dotazione di spellafibre e forbici

Tutti gli altri requisiti sono conformi.

**Ditta Urology Diagnostic – Litho 35 W – Quanta**

**viene esclusa:**

in riferimento alla frequenza richiesta da 1 a 20Hz, viene dichiarata frequenza da 3 a 30 Hz. Non è indicata la potenza massima di picco.

non viene specificato il funzionamento impulsato (solo programmi preimpostati).

Non è indicata la durata dell'impulso, non permette la regolazione della durata dell'impulso durante l'intervento

non è presente la luce guida ad intermittenza quando il sistema è in standby

non è presente sportello di connessione automatico

non è dotato di sistema di bloccaggio in caso di potenza superiori a quelle supportate dalla fibra stessa

Non viene specificata la dotazione di spallafibre e forbici

Tutti gli altri requisiti sono conformi.

*Clara Fontana*  
Autore: *Luca Casanovi*  
*Roberto Agazzi*

*de*



Sistema di raffreddamento		Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Durata impulso	CRITERIO 4	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
		Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
		Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
	Frequenza	CRITERIO 5	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Giudizio Commissario 2			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 2			0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Giudizio Commissario 3			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 3			0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
		Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
		Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
		Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	

1,00

9,00

Regolazione intensità sonora, immediatezza

CRITERIO 7	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
CRITERIO 9	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Valutazioni cliniche e fisico strumentali	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature on the left side of the table.  
 - Initials "M" and "P" with a star-like mark on the right side of the table.

Caratteristiche migliorative proposte in sede di offerta tecnica						
Punti qualità attribuiti Commissario2	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	

*de*

*Am*  
*de*  
*de*

LOTTO 01

LASER PER IL TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	CARLO BIANCHI	DBI	FAD SRL	OLYMPUS ITALIA	UROLOGY DIAGNOSTIC
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	69,00				
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>					
Coefficiente di riparametrizzazione	CARLO BIANCHI	DBI	FAD SRL	OLYMPUS ITALIA	UROLOGY DIAGNOSTIC
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>					
Punti qualità riparametrizzati	CARLO BIANCHI	DBI	FAD SRL	OLYMPUS ITALIA	UROLOGY DIAGNOSTIC
	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

*de*

*Aty*  
*de*  
*de*

